



СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ МУЖЧИН




ОДНА ИННОВАЦИОННАЯ
РЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА
ДВА ЭФФЕКТИВНЫХ ПОДХОДА
К ЛЕЧЕНИЮ СТРЕССОВОГО
НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У МУЖЧИН

Promedon
— People + Innovation

Универсальное решение, учитывающее показания, состояние пациента и подходы к лечению – трансобтураторный и позадилонный.

Argus T регулируемая система

- Показана при легкой, средней и тяжелой степенях СНМ.
- Предназначена для трансобтураторного доступа.

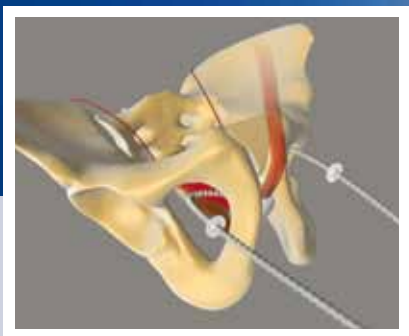

Argus регулируемая система

- Показана при широком спектре СНМ, от умеренной до тяжелой степени.
- Предназначена для позадилонного доступа.





Регулируемая система Argus представляет собой проверенное в течение **10 лет инновационное** и эффективное решение для лечения стрессового недержания мочи (СНМ) у мужчин после простатэктомии. Из двух вариантов можно выбрать наилучший подход в зависимости от показаний и состояния пациента.

Универсальность

- Система **Argus T**, основанная на тех же проверенных 10 годами принципах действия и эффективности, что и оригинальная регулируемая система **Argus** (предназначенная для позадилоного доступа), имеет минимальный слепой отрезок для трансобтураторного доступа.
- Регулируемая система **Argus** в двух вариантах представляет собой простой в использовании полный хирургический набор, облегчающий проведение безопасных, воспроизводимых и малоинвазивных процедур.
- Хирургическая методика применения обеих систем не требует долгого обучения.
- Система не требует участия или манипуляций пациента.

Регулируемость

- Уникальной особенностью **регулируемой системы Argus** является точно контролируемая регулировка во время и после операции (при необходимости).
- Система фиксации с эксклюзивной комбинацией прочных силиконовых фиксаторов и колец обеспечивает превосходный баланс стабильности и регулируемости.
- В зависимости от потребностей и состояния каждого пациента может быть выполнена регулировка натяжения.
- Рентгеноконтрастные регулировочные кольца обеспечивают очную точку отсчета как для надежной фиксации, так и для послеоперационной регулировки натяжения.

Эффективность

- Регулируемые системы **Argus** и **Argus T** предлагают точный и воспроизводимый метод создания минимального натяжения для успешного удержания мочи.¹

Клинические данные

Полученные за десять лет клинические данные и долгосрочные результаты показывают уровень излечения до 87,5% с применением системы **Argus**.²⁻³⁻⁴⁻⁵⁻⁶⁻⁷⁻⁸⁻⁹⁻¹⁰⁻¹¹

1- Rutkowski M., Hübner W.A. Landeskrankenhaus Korneuburg, Dept. of Urology, Korneuburg, Austria. Male sling adjustment: Can the retrograde leak point pressure help to reduce postoperative urethral lesions?. European Urology Supplements - February 2012 (Vol. 11, Issue 1, Page e291, DOI: 10.1016/S1569-9056(12)60288-7). 2- Hübner, W. A. et Al. Adjustable bulbourethral male sling: experience after 101 cases of moderate-to-severe male stress urinary incontinence. BJU Int. 2011 Mar;107(5):777-82. doi: 10.1111/j.1464-410X.2010.09619.x. Epub 2010 Oct 21. 3- Romano SV. et Al.. Long-term results of a phase III multicentre trial of the adjustable male sling for treating urinary incontinence after prostatectomy: minimum 3 years. Actas Urol Esp. 2009 Mar;33(3):309-14. 4- Deirdre M. Bochove-Overgaauw, Bart Ph. Schrier. An Adjustable Sling for the Treatment of all degrees of male stress urinary incontinence: Retrospective evaluation of efficacy and complications after a minimal follow-up of 14 months. The Journal of Urology-April 2011 (Vol. 185, Issue 4, Pages 1363-1368, DOI: 10.1016/j.juro.2010.11.075). 5- Bauer R1, Rutkowski M2, Roosen A1, Pfau A2, Huebner W2. 1.Ludwig-Maximilians-University, 2. Clinic of Korneuburg, Dept. of Urology, Korneuburg, Austria. Efficacy and complications of the Argus T sling. 42nd Annual Meeting of ICS. Beijing, China. 2012. Abstract#782. 6- Kachmazov A.A., Romich V.V., Serebryanyi S.A. Institute of Urology, the Health Ministry of the Russian Federation, Moscow. Adjustable sling system Argus in treatment of male stress incontinence. Clinic and Experimental Urology Russian Journal. (Экспериментальная и Клиническая урология № 1 2012). 7- Ricarda M. Bauer1, Michael Rutkowski2, Alexander Kretschmer1, Andrea Pfau2, Christian G. Stiefl, Wilhelm A. Hübner2. 1Urologische Klinik und Poliklinik, Ludwig-Maximilians-Universität, München; 2Klinikum Korneuburg, Österreich. Results of the Argus T sling for the treatment of male stress incontinence. DGU Congress 2013, Dresden, Germany. 8- Han J1, Yoo D2, Song M H3, Chun J Y3, Choo M3.1. Pusan National University Yangsan Hospital, 2. Eulji University School of Medicine, 3. University of Ulsan College of Medicine, Asan Medical Center. Comparison of the efficacy between Artificial Urinary Sphincter and Argus Male Sling after prostate surgery in moderate incontinence patients. 43rd Annual Scientific Meeting of the International Continence Society (ICS), 2013. Barcelona, Spain. Abstract #747. 9- Lima J P C, Pompeo A C L, Bezerra C A.Faculdade de Medicina do ABC - São Paulo, Brasil. Sub-urethral sling for male urinary incontinence: randomized clinic trial of two slings. 43rd Annual Scientific Meeting of the International Continence Society (ICS), 2013. Barcelona, Spain. Abstract #266. 10- Nadeau, Genevieve Sourial, Michael-Wadiah Bureau, Michel Tu, Le-Mai Bailly, Greg Steele, Stephen S. Carlson, Kevin Dwyer, Neil Valiquette, Luc Vézina, Jean-Guy Herschorn, Sender et al. Canada. Retrospective Evaluation of Efficacy and Safety of Argus Sling for Treatment of Male Stress Urinary Incontinence: the Canadian experience. The Journal of Urology, Vol. 191, Issue 4, e338. doi: 10.1016/j.juro.2014.02.952. 11- Trigo Rocha F1, Bruschinih1, Cristiano G1, Miguel S1. 1. Division of Urology - São Paulo University. Adjustable Transobturator Sling (Argus T®) for the treatment of Post Radical Prostatectomy Urinary Incontinence (PRPUI). Long term follow up In 20 Patients. 44th ICS Annual Meeting 2014. Rio de Janeiro, Brazil. Abstract #491.

Регулируемая система Argus T: Трансобртураторный доступ при лечении СНМ



Доказанные безопасность и эффективность

- Специально разработана для трансобртураторного доступа.
- Регулируемая система показана пациентам с легкой и умеренной степенью СНМ.
- Менее инвазивная хирургическая техника, чем при позадилоном доступе. Сводит к минимуму риск перфорации мочевого пузыря.



Усовершенствованная конструкция для трансобртураторного доступа

- Особая высокоэффективная конструкция системы туннелизации упрощает этапы хирургического операции. Иглы с крючком на конце позволяют безопасно вводить и разворачивать фиксаторы имплантата.
- Иглы имеют разный диаметр, что обеспечивает минимальную инвазивность при максимальном контроле вращения при трансобртураторном доступе.
- Иглы изогнуты с учетом мужской анатомии.



В регулируемую систему Argus T входят:

- 1 имплантат Argus T + 2 фиксирующих/регулирующих кольца (шайбы).
- 2 иглы с эргономичными ручками для вращательных движений.
- 2 фиксирующих/регулирующих кольца (шайбы).
- 2 позиционера колец (шайб).
- 1 линейка (для регулировки ретроградного уретрального давления).




Регулируемая система Argus: Позадилонный доступ для лечения СНМ



Проверенные принципы и эффективность

- Специально разработанная регулируемая система для позадилонного доступа.
- Показана при широком спектре стрессового недержания мочи у мужчин от легкой до тяжелой степени.
- Стандартизированный и воспроизводимый позадилонный метод Argus основан на 10-летнем опыте.

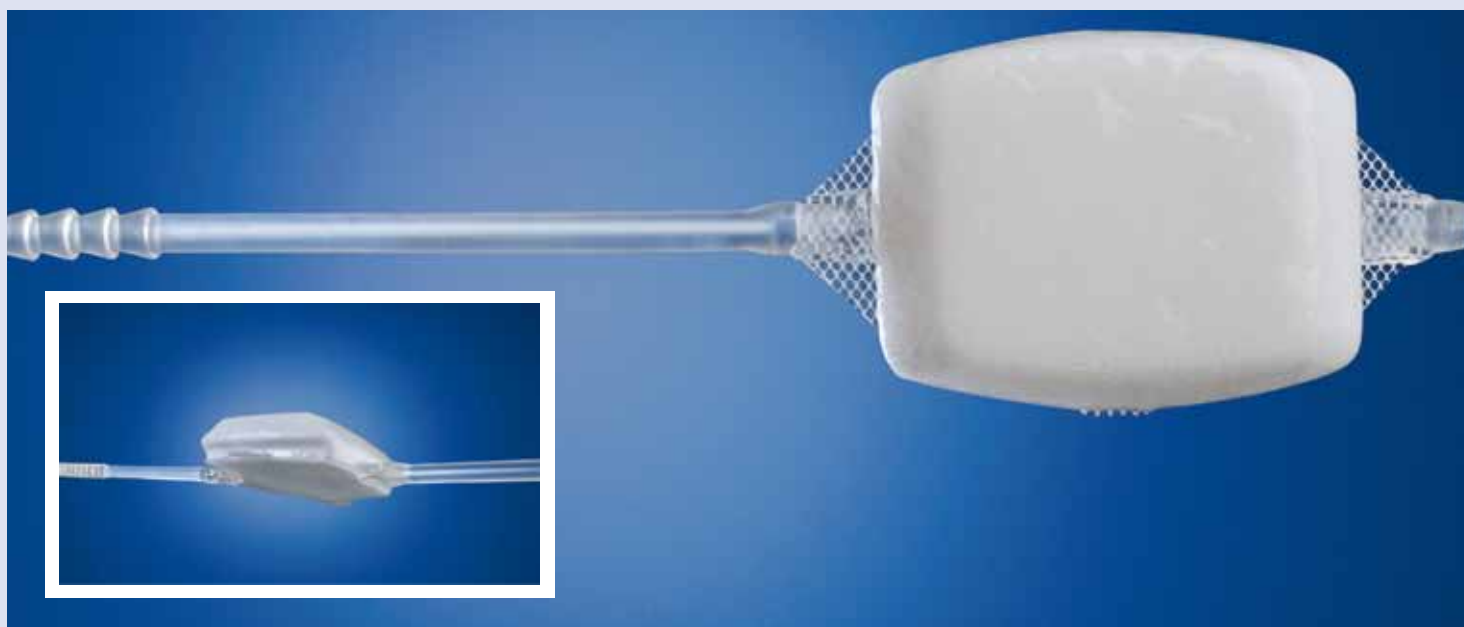

В регулируемую систему Argus входят:

- 1 имплантат Argus + 2 фиксирующих/регулирующих кольца (шайбы).
- 2 иглы с эргономичными ручками.
- 2 фиксирующих/регулирующих кольца (шайбы).
- 2 позиционера колец (шайб).
- 1 линейка (для регулировки ретроградного уретрального давления).





ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

РЕГУЛИРУЕМАЯ СЛИНГ-СИСТЕМА ARGUS T

Номер для заказа: KIT-MT-01

1 Изделие для лечения недержания мочи Argus T + 2 регулировочных кольца (шайбы): S-42M-AFhT

2 Иглы с ручками: DPN-HHA

2 Регулировочные кольца (шайбы): AR-M

2 Позиционеры колец (шайб): P-02-A

1 Линейка: R-PU

РЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА ARGUS

Номер для заказа: KIT-M-01b

1 Изделие для лечения недержания мочи Argus + 2 регулировочных кольца (шайбы): S-42M-AFhL

2 Иглы с ручками: DPN-MA

2 Регулировочных кольца (шайбы): AR-M

2 Позиционера колец (шайб): P-02-A

1 Линейка: R-PU

